


Les cellules de mesure du type CAA2530 et CAA2531 servent à mesurer le chlore Total, c'est-à-dire tous les chlores liés mesurés au DPDn°4, dans les eaux potables, sanitaires, de procédés ou dans les eaux de piscine pour la détermination des chlores combinés (Avec sonde de chlore actif).

2. Caractéristiques techniques

Grandeur mesurée:	Chlore Total
Domaine d'utilisation :	Eaux potable, sanitaires, process, piscines. (Exempt de tensioactifs)
Plages de mesure :	0,1 - 10 ppm, réf. CAA2530 0,02 - 2 ppm, réf. CAA2531
Plage de pH :	5,5 - 9,5 pH
Plage de température :	5 - 45 °C (avec compensation de température)
Pression maximale :	3 bars
Débit d'alimentation :	mini : 20 l/h Maxi : 100 l/h Recommandé : 30 l/h
Temps de démarrage:	premier étalonnage après 2 H
Etalonnage définitif	après 24 H
Durée de vie de la : Membrane	normalement 1 an (en fonction de la qualité de l'eau)
Réactif chimique interne :	Gel de KI, réf. CAA2511
Matériau du capuchon :	PVC bleu, réf. CAA2509
Matériau de la tige de sonde :	PVC noir
Type de protection	I P 65
Tension d'alimentation	16-24VDC
Signal de sortie	4-20mA

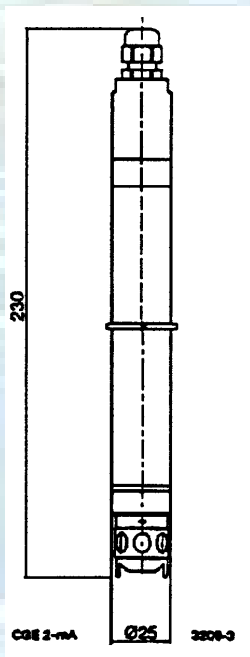

3. Raccordement électrique

Tournez la partie supérieure de la cellule de mesure de mesure d'un quart de tour dans le sens anti-horaire et retirez-la. Desserrez le raccord PG 7 et passez le câble bifilaire (voir spécification) (attention : prévoyez environ un jeu de 5 cm de conducteur de mesure isolée dans la cellule de mesure). Raccordez ensuite le câble bifilaire à la borne (1 pôle positif, 2 pôle négatif). Enfoncez complètement la partie supérieure dans le corps et bloquez-la dans le sens horaire jusqu'en butée. Après avoir bloqué l'écrou du raccord PG, monter la cellule de mesure dans sa chambre de passage.



Attention : Le signal de sortie de la cellule ne possède pas de séparation galvanique.

4. Montage/installation




Attention : Ni la membrane, ni l'électrode ne doivent être touchés ou endommagés.

Avant un montage de la sonde dans la chambre de mesure, fermez les robinets d'arrêt en amont et en aval du capteur. Mettez le système hors pression. Prenez des mesures de protection appropriées lorsque vous manipulez des solutions ou de l'eau chlorée.

4.1 Remplissage du capuchon à membrane avec de l'électrolyte

Ouvrez le flacon d'électrolyte (Gel de KI), mettez la canule sur le haut du flacon et expulsez l'air excédentaire (attention : l'électrolyte est sensible à la lumière). Appuyez ensuite sur le flacon d'électrolyte et expulsez lentement et sans faire de bulle d'air, le gel dans le capuchon à membrane. Retirez progressivement le flacon. Le capuchon est entièrement rempli lorsque l'électrolyte est visible au bas du filetage.



Attention : Le remplissage du capuchon doit se faire sans bulles d'air. Une réutilisation du capuchon qui ont été rempli est impossible.

Posez ensuite le capuchon à membrane sur la tige d'électrode tenue verticalement et bloquez à la main jusqu'en butée. Par un perçage sous le joint plat qui se trouve dans la gorge du capuchon à membrane s'échappe d'abord de l'air, puis l'électrolyte excédentaire. Essayez l'électrolyte écoulé avec un papier absorbant doux.

4.2 Montage dans la chambre de mesure

Avant le montage dans la chambre de mesure, il faut passer le joint torique coté capuchon, en dessous de la rondelle de serrage positionnée dans une gorge de la tige. Glissez ensuite la bague de serrage par dessus la tige et montez la tige ainsi complétée dans le capteur de débit. Bloquez l'écrou de serrage jusqu'à ce que le joint torique assure l'étanchéité. La profondeur de montage correcte de la sonde est déterminée par la bague de serrage.

5. Etalonnage

Un étalonnage du point zéro de la cellule de mesure à membrane n'est pas nécessaire. L'étalonnage de la pente est effectué à l'aide d'un dispositif de mesure du chlore approprié (DPD4) et ajusté au régulateur/appareil de mesure conformément à la notice.

Afin d'effectuer un étalonnage correct, la sonde doit être utilisée dans la chambre de mesures avec les débits recommandés (voir caractéristiques techniques).

Recommencez l'étalonnage à intervalles réguliers. Les intervalles d'étalonnage sont fonction de l'utilisation de la sonde et sont généralement de 3 à 4 semaines pour le traitement d'eau de process.



Attention : Après un changement de membrane, un étalonnage de la pente doit être réalisé dans tous les cas !

6. Identification des connexions

1 : Fil blanc 2: Fil bleu

7. Accessoires

Capuchon à membrane bleu : référence. CAA2509
Electrolyte ou gel de KI : référence. CAA2511
Kit de fixation 1"(Joint + écrou) : référence. CAA2510
Kit de maintenance : référence. CAA2562
Fourreau de transport : référence. FTH2500